

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

08.10.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 15/10/2020 tarih ve saat 16:00'a kadar Başta bİplİğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	BLANKET/HASTA ISITMA CİHAZLARI, HASTA ISITMA- SOĞUTMA CİHAZI HAVALI SİSTEM	1	ADET		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**


TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

GELEKLE

Hastanemiz Servisinde Amelyothone servisinde kullılmak üzere 1 adet hasta-ısıtma cihazına ihtiyacımız vardır. Gereğini bilginize arz ederim.

Canan KORKMAZ
Tasınır Kayıt Yetkilisi




Canan Korkmaz
K

Hasta Isıtma Cihazı Teknik Özellikleri

- 1-Cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır
- 2-Cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava üfleterek konvektif ısıtma özelliğinde olmalıdır
- 3-Cihaz birlikte kullanıldığı battanilerde üniform bir dağılım sağlamalıdır
- 4-Cihaz, 32, 38, 43C olmak üzere 3 adet ısı ayarına sahip olmalıdır
- 5-İlgili ısı ayar düğmesi seçildiğinde cihaz üzerinde o ısıya ait ışık yanmalıdır
Isı ayarındaki tolerans ± 2 C° olmalıdır
- 6-Hortum çıkışında bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda çalıştığını doğrulamalıdır
- 7-Düşük ve yüksek üfleme hız ayarları bulunmalıdır
- 8-Cihaz içerisinde bulunan filtre 0.3 μ 'a kadar filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 9-Cihaz üzerinde dijital ekran bulunmalıdır
- 10-Cihaz ameliyathane içerisinde taşınmasını kolaylaştıracak ve kullandığı battaniyelerin muhafazasını sağlayacak üzerine monte edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir.
- 11-Cihaz, istenirse serum askısına montaj edilebilir özellikte olmalıdır
- 12-Cihaz üzerindeki tuşlar standby, ortam (ambient) sıcaklığı, 32°C, 38°C, 43 °C, düşük hız ve yüksek hız tuşlarından oluşmalıdır. Bunların çalışması durumunda yanlarında bulunan ışık yanmalıdır.
- 13-Cihaz üzerinde hata (fault) ve aşırı ısınma (over temp) uyarı ışıkları bulunmalıdır ve bu durum ortaya çıktığında ilgili ışık yanmalıdır.
- 14-Hata durumlarında cihazın alarm sistemi devreye girmeli ve ses ile uyarı yapmalıdır. Alarmın devrede olması durumunda cihaza verilen komutlar bloke edilmelidir.
- 15-Cihaz üzerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında battanilerin bağlanacağı nokta tanımlanmış olmalıdır.
- 16-Cihaz, sıcaklığın 56 °C'yi (+/- 5 C) aştığı durumda alarm sistemini devreye sokmalıdır ve bu durumda cihaz bloke olmalıdır.
- 17-Numune denendikten sonra uygunluk verilerek alımı yapılacaktır.

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi







BLANKET / HASTA ISITMA CİHAZLARI, HASTA ISITMA - SOĞUTMA CİHAZI HAVALI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

Cihazların bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu cihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.

1. Cihazların **servis kılavuzları** (cihazın mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren servis manueeli) Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilmelidir.
2. Cihazlar en az **2 yıl** garantili olmalıdır ve en az 10 yıl yedek parça teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır. Garanti süresi boyunca periyodik bakımları kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yapılacaktır. (2 ayda bir)
3. Yükleniciye arıza bildirim günde 24 (yirmi dört) saat, haftada 7 (yedi) gün ve tüm bayram, resmi tatil günleri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoluyla yapılabilir. Arıza bildirim telefon ile 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır.
4. Arıza bildirimini izleyen 24(yirmi dört) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale edilecektir. Bu süre mesai dışı zamanlarda ve resmi tatil günlerinde 48 (kırk sekiz) saattir. Arıza çözümü 36 saatten fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan geçici bir cihaz bırakılacaktır.
5. Garanti süresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik ölçümü en az **% 95 (% 95 up-time)** olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, % 95 lik up-time oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en fazla 18.2 gün (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir. Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde arıza veya diğer etkiler nedeniyle 18.2 günden daha az (% 5 down-time) hizmet veremezler ise bu sürenin bakım-onarım süresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak 18.2 günü aşan süre kadar bakım-onarım zamanına iki kat süre eklenecektir ve bu sürede cihaz bakımları ücretsiz olarak yapılacaktır. **Down time süresi arızanın firmaya bildirilmesiyle başlayacak, onarım tamamlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona erecektir.** İstisna parçanın hastane idaresi tarafından temin edildiği hallerde yedek parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye teslim edilmesi arasında geçen süre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak **istisna**

Canan KOZ
Taşınır Kay.


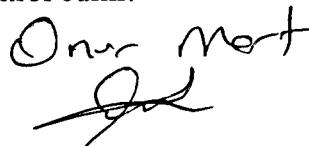
Onur Mert


parça alımının yüklenici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş firmaya ulaştıktan sonra)10 gün sonra down time başlar.


6. Cihazların garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onarımı orijinal kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde ve yine belirtilen sürelerde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
7. Cihazlar ile birlikte **fabrika çıkış kalibrasyon raporları** Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilecektir.Ayrıca kalibrasyon etiketleri cihazlara yapıştırılmış olmalıdır.Bu etiket içerisinde Kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi bilgileri mutlaka olmalıdır.
8. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen cihazların marka, model ve seri numaraları yazacaktır.
9. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kurum istediği takdirde cihaz demosu isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma uymuyor ise firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
11. İhaleyi alan firma, cihazların kullanımına ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün veya günlerde ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli tarafından kayda alınacaktır.
12. İhaleyi alan firma, cihazların bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile cihaz açılış kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğitimini kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün veya günlerde ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli tarafından kayda alınacaktır.
13. Alınacak ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
14. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ya da ÜTS kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.

Özcan KORKMAZ
Ticari Kayıt Yetkilisi



Onur Mert


15. Kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.) Alınan görüş yazısı satın alma dokümanlarına eklenmelidir. maddesinin eklenmesi gerekmektedir. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir. Ayrıca marka model ve seri numarası yazılmalıdır. İstenilenler faturalarda olmadığı takdirde fatura geri gönderilecektir.
16. Cihazla ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
17. Bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.
18. Yüklenici firmadan satış yeri yeterlilik belgesi istenecektir. Yüklenici firma ibraz etmediği takdirde cihaz kullanılmış olsa bile teslim edilecek ve hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Canan KORKM
Taşınır Kayıt Yetkili


Oru Mert
