



T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

11.04.2022

**PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65  
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER  
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	REFEKATÇİ KOLTUĞU	15	ADET			
2	ÇALIŞMA KOLTUĞU	15	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

**Son Teklif Tarih ve saati :19/04/2022 - 12:00**

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  2. **Ödeme;** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
  3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
  4. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi  
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,  
63500 Akçakale/Şanlıurfa  
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma  
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465  
Faks : 0 414 318 94 23 - 0 414 318 94 65

11.04.2022

## GEREKÇE

Hastaneler servisleri ve birimlerinde kullanılmak üzere  
15 adet memur HPT gelişme koltaçına  
ihtiyacı duyulmaktadır

Gereğini bilgilerinize arz ederim,

İbrahim Öner SAY

*Jey*

HAKKI UKIL  
SAGLIK TEKNİKERİ


## REFAKATÇI KOLTUĐU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1-Refakatçi koltuĐunun eni ve geniŐliĐi 80 cm (+/-5cm) olmalıdır.
- 2-ArkalıĐının yerden yuksékliĐi 95cm(+/-5cm) olmalıdır.
- 3-Arkalık yuksékliĐi 50 cm(+/- 5 cm ) olmalıdır.
- 4- Oturma geniŐliĐi 60 cm (+/- 2cm) olmalıdır.
- 5- Oturma derinliĐi 60 cm (+/- 2 cm ) olmalıdır.
- 6- Kol geniŐliĐi 10 cm (+/- 2 cm ) olmalıdır.
- 7-KoltuĐun arkalıĐı 3 kademeli yataklı olacak Őekilde, son kademe yatak olacak Őekilde olmalıdır.
- 8- İçinden sür yat Őeklinde çekmeceli mekanik aksam olmalıdır.
- 9-KoltuĐun sür yatının içinden çıkan yatak 45x65 cm (+/-2 cm ) ölçülerinde olmalıdır.
- 10- Sünger kalınlıĐı 10 cm 32 dans (+/- 2) olmalıdır.
- 11- KoltuĐun kolları deri, oturma yerleri silinebilir kumaŐ olmalıdır.
- 12- En az iki yıl garantili olmalıdır.
- 13- Numune üzerinde maddeler deĐerlendirilecektir.

## ÇALIŞMA KOLTUĞU MEMUR TİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Oturma derinliği 46 cm olmalıdır.
- b) Oturma yüzey genişliği 50 cm olmalıdır.
- c) Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği 64 cm olmalıdır.
- d) Arkalık genişliği 48 cm olmalıdır.
- e) Yıldız formlu ayak çapı 59 cm olmalıdır.
- f) Oturma yeri ve arkılığı belirli oranda yatma hareketi yapabilen kol yardımıyla en az iki pozisyonda kilitleme yapabilen mekanizmalı olmalıdır.
- g) 360 derece kendi etrafında dönebilen olmalıdır.
- h) Kolçaklar sert plastikten olmalıdır.
- i) Ayaklar ve tekerlekler sert plastik ayak ve plastik teker olmalıdır.
- j) İskeletin tamamı dökme süngerden olmalıdır.
- k) Tolerans değeri  $\pm 2$  cm olmalıdır.

WAB

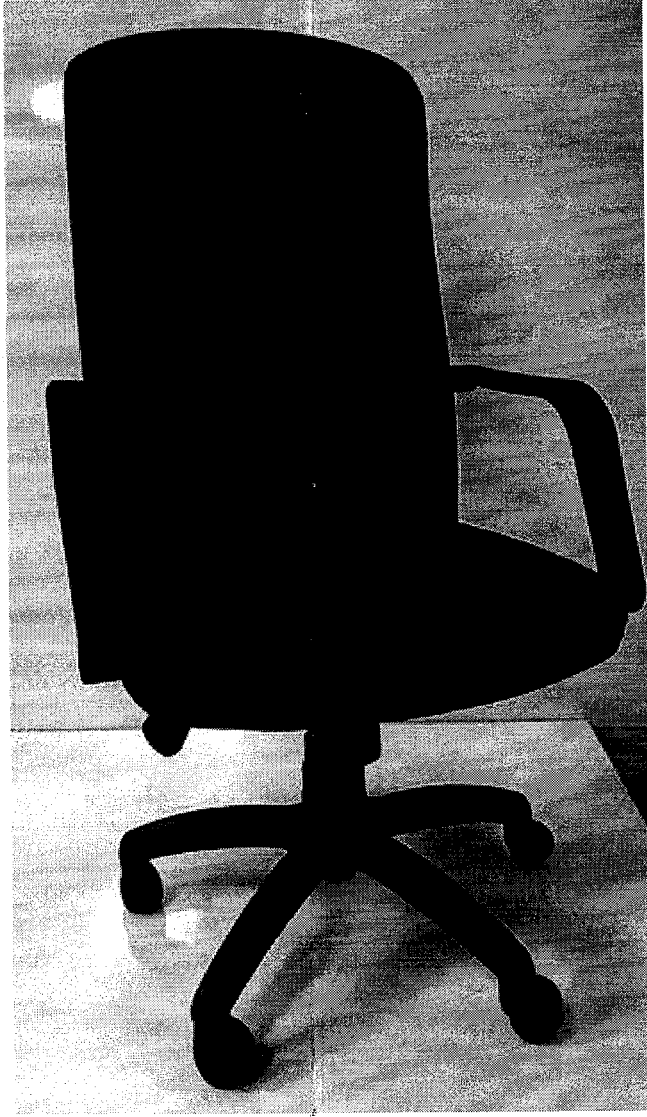

Ürün görseldir.

Örnek Görsel

